smiths medical

bringing technology to life

donner vie à la technologie

Système de drainage DRENTECH® Variant et Variant S

Procédure de mise en place

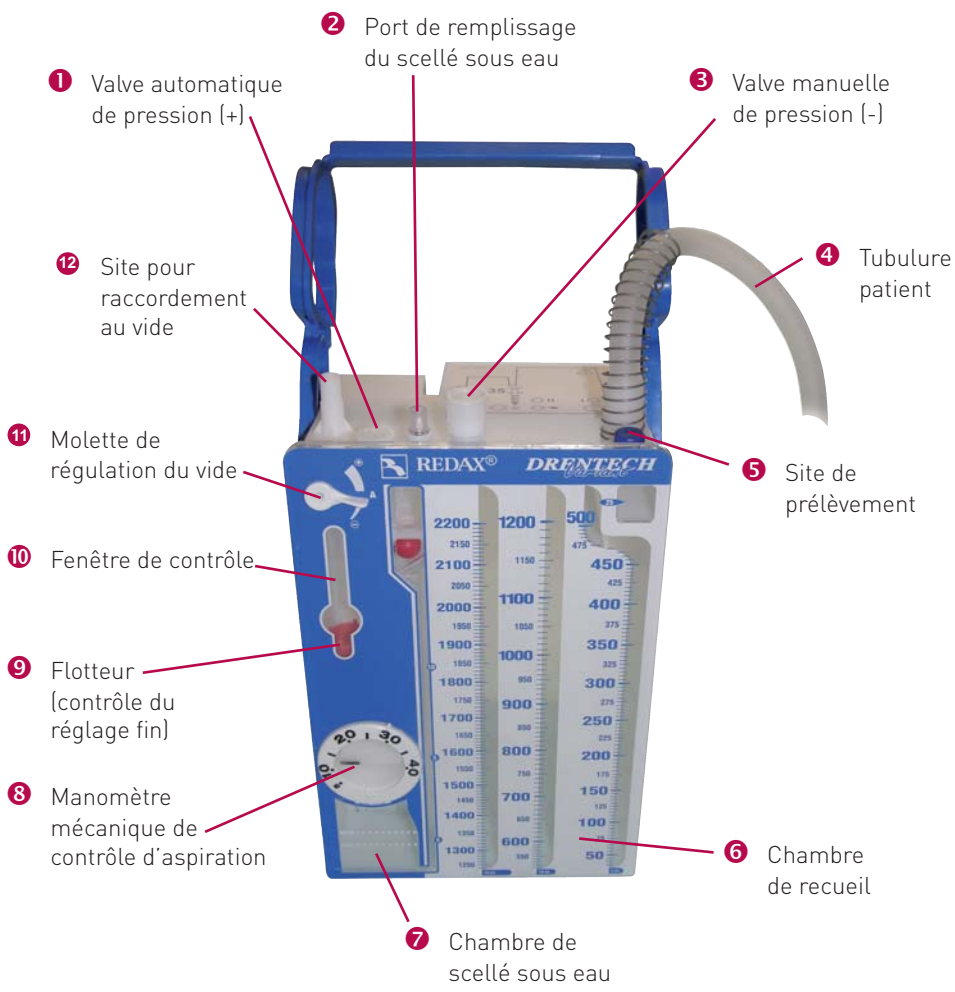
❶ Valve automatique de pression (+)
❷ Port de remplissage du scellé sous eau
❸ Valve manuelle de pression (-)
❹ Tubulure patient
⓬ Site pour raccordement au vide
⓫ Molette de régulation du vide
❺ Site de prélèvement
❿ Fenêtre de contrôle
❾ Flotteur (contrôle du réglage fin)
❽ Manomètre mécanique de contrôle d'aspiration
❻ Chambre de recueil
❼ Chambre de scellé sous eau

Désignation	Référence
Drentech® Variant - Mono chambre de recueil	10110PX
Drentech® Variant - Double chambre de recueil	10111PX
Drentech® Variant S - Usage pédiatrique - Mono chambre de recueil	10117PX
Drentech® Variant - Mono chambre de recueil avec clamps	10118PX
Drentech® Variant - Double chambre de recueil avec clamps	10119PX

MISE EN GARDE

- Avant utilisation du dispositif, se rapporter au mode d'emploi fourni.
- Avant le transport du patient, déconnecter le système de la source de vide.
- Veiller à ce que l'unité de drainage soit toujours maintenue sous le niveau patient.
- Veiller à ce que la tubulure de drainage soit exempte de toute courbure ou plicature, afin d'éviter toute occlusion.

1. Ôter le dispositif de son emballage en prenant soin de respecter les procédures d'asepsie.

2. Le dispositif fonctionne aussi bien par gravité que par aspiration (à l'aide d'une source de vide).

3. A l'aide d'une seringue d'eau stérile remplir la chambre de scellé sous eau jusqu'au trait inférieur au minimum (pour indication de 35 cc à 50 cc).

4. Sélectionner le niveau de dépression choisi par le médecin en tournant le manomètre mécanique ❽ jusqu'à la valeur d'aspiration souhaitée (entre -5 cm H_2O et - 40 cm H_2O).

5. Connecter la tubulure patient ❹ au drain du patient.

6. Raccorder le dispositif au vide par l'intermédiaire du site de raccordement ⓬. Pour que le système fonctionne correctement, la source de vide doit fournir au minimum -100 cm H_2O.



7. Une fois le niveau de dépression réglé par le manomètre et le système connecté à la source de vide, le flotteur rouge ❾ doit se trouver en position centrale **(a)** dans la fenêtre ❿ (si plusieurs systèmes sont utilisés simultanément, chaque flotteur doit être en position centrale).
Si le flotteur reste immobile (position basse), ceci indique qu'il n'y a pas assez de flux en provenance du vide **(b)**.
A l'inverse, si ce dernier flotte vers le haut, le niveau de flux est alors trop élevé **(c)**.

Vous pouvez régler l'arrivée de vide à l'aide de la molette ⓫ de telle manière que le flotteur soit toujours en position centrale de la fenêtre.

8. Le système est maintenant prêt à fonctionner.

PURGE DE LA PRESSION NÉGATIVE EXCEDENTAIRE

En cas de pression négative excessive (indiquée par la hauteur de la colonne d'eau dans la chambre de scellé sous eau), presser la partie supérieure de la valve manuelle de pression négative ❸.
Une fois la compensation complète obtenue de la pression négative, relâcher la valve.

Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles - 94656 RUNGIS Cedex
Tél : 01 58 42 50 00 - Fax : 01 58 42 50 50
e-mail : morl.info@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com
Smiths Medical - Une division de Smiths Group plc

Fabriqué par REDAX srl. - Mirandola ITALIE CE 0123

PORTEX™

DRAIN09-Ed0910-RevA